

Control extern de calitate ROLAB-IC

Oferta de prețuri – 2026

POLITICA DE DISCOUNT – vă rugăm să ne contactați pentru a vă personaliza o ofertă conform nevoilor dvs.!

ROLAB-IC oferă:


- Un program de control extern al calității conform SR EN ISO/CEI 17043.
- Un program de control extern al calității notificat conform normelor Ministerului Sănătății–CNAS.
- Un program de control extern acreditat RENAR.
- Flexibilitate și asistență tehnică în alegerea schemelor de încercări de competență.
- Materiale de lucru cu omogenitate și stabilitate garantată și verificată care pot fi folosite pe o gamă largă de echipamente analitice, produse de firme cu renume în domeniu.
- Compararea între laboratoare de analize medicale la nivel național.
- Raportarea rezultatelor prin interfața web a ROLAB-IC accesibilă cu orice tip de browser.
- Rapoarte de evaluare cuprinzătoare și ușor de interpretat. Asistență tehnică coordonată de specialiști cu o vastă experiență în domeniu.
- Posibilitatea de a contracta mai multe participări pentru o rundă de intercomparări.

Cod schema	Denumire schema	Analiți	Matrice OIC	Pret (RON fără TVA)/ Participare)
Programul de hematologie – Valoare de consens ca valoare atribuita				
SIC-EQA-HEM-01	Hemoleucogramă automată: Determinarea automată a elementelor figurate ale sângelui - 5 DIFF SIC-EQA-HEM-01.1 Pentru echipamentele specificate in Anexa 1.1 5 DIFF SIC-EQA-HEM-01.1	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW, neutrofile %, neutrofile #, limfocite %, limfocite #, monocite %, monocite #, eozinofile %, eozinofile #, bazofile %, bazofile #		399
	Hemoleucogramă automată: Determinarea automată a elementelor figurate ale sângelui - 3 DIFF SIC-EQA-HEM-01.2 Această schemă se organizează doar în rundele Mai și Noiembrie	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW		329
SIC-EQA-HEM-02	Imunohematologie SIC-EQA-HEM 02.1	Grup sanguin ABO si factor Rh		119
	Imunohematologie SIC-EQA-HEM 02.2	Anticorpi anti Rh		124
SIC-EQA-HEM-03	Determinarea HbA1c SIC-EQA-HEM-03	Hemoglobina glicozilata		219
SIC-EQA-HEM-04	Viteza de sedimentare a hematiilor SIC-EQA-HEM 04.1	VSH-metoda manuala si automata		159
	Viteza de sedimentare a hematiilor SIC-EQA-HEM 04.2	VSH-Analizor Alifax		379

SIC-EQA-HEM-05 Citologie	Leucocite SIC-EQA-HEM-05.1 Iconografic	Leucocite numarare diferentiala (metoda manuala), evaluare morfologica celule sanguine		85
	Reticulocite SIC-EQA-HEM-05.2 Iconografic	Numar reticulocite		95
SIC-EQA-HEM-06 Hemostaza	Hemostaza SIC-EQA-HEM-06	Timp Quick, INR, Fibrinogen, APTT		95

Cod schema	Denumire schema	Analiti	Pret (RON fără TVA)/ Participare)
Programul de Chimie clinica – Valoare de consens ca valoare atribuita			
SIC-EQA-CCL-01 Chimie clinica	Chimie clinica prin spectrofotometrie SIC-EQA-CCL-01.1	Glucoza, Uree, Proteina totala, Calciu total, Calciu ionic, Fier, Acid uric, Creatinina, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Trigliceride, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Magneziu, TGO, TGP, GGT, Fosfaza alcalina, LDH, Amilaza, TSH, FT4, Cortisol, Fosfor, Potasiu, Sodiu, Bicarbonat de sodiu seric, Creatinkinaza CK.	79
	Electroforeza proteinelor SIC-EQA-CCL-01.3	Albumina, Alfa 1 Globulina, Alfa 2 Globulina, Beta Globulina, Gamma Globulina	79
SIC-EQA-CCL-02 Examen complet de urina (bandelete urinare si microscopie optica)	Chimie clinica: Examen bioghimic al urinii (determinare cantitativa) SIC-EQA-CCL-02.1	Glucoza, Proteine urinare, Creatinina, Albumina	84
	Chimie clinica: Examen biochimic al urinii (determinare calitativa) - Strip SIC-EQA-CCL-02.2	Strip urina: Glucoza, Corpi cetonic, Proteina totala, Urobilinogen, Bilirubina, Nitriti, Leucocite, Eritrocite, densitate, pH Sediment urina (OIC analizat microscopic): Leucocite, Eritrocite, Cristale, Cilindri	83

	Chimie clinica: Examen biochimic al urinii (determinare calitativa) - Sediment urina SIC-EQA-CCL-02.3 Iconografic	Sediment urina (Iconografic): Leucocite, Eritrocite, Cristale, Cilindri	69
	ANALIZOARE BECKMAN COULTER Familia de echipamente iRICELL / iCHEMVELOCITY Chimie clinica: Examen biochimic al urinii (determinare calitativa) – Strip + probă dedicată leucocite și sediment urină (OIC analizat microscopic) + Sediment urină Iconografic (schemele SIC-EQA-CCL-02.2 + SIC-EQA-CCL-02.3 dedicate pentru analizoare din familia amintită) SIC-EQA-CCL-02.4	Strip urina: Glucoza, Corpi cetonici, Proteina totala, Urobilinogen, Bilirubina, Nitriti, Leucocite, Eritrocite, densitate, pH Sediment urina (OIC analizat microscopic): Leucocite, Eritrocite, Cristale, Cilindri Sediment urina (Iconografic): Leucocite, Eritrocite, Cristale, Cilindri	239

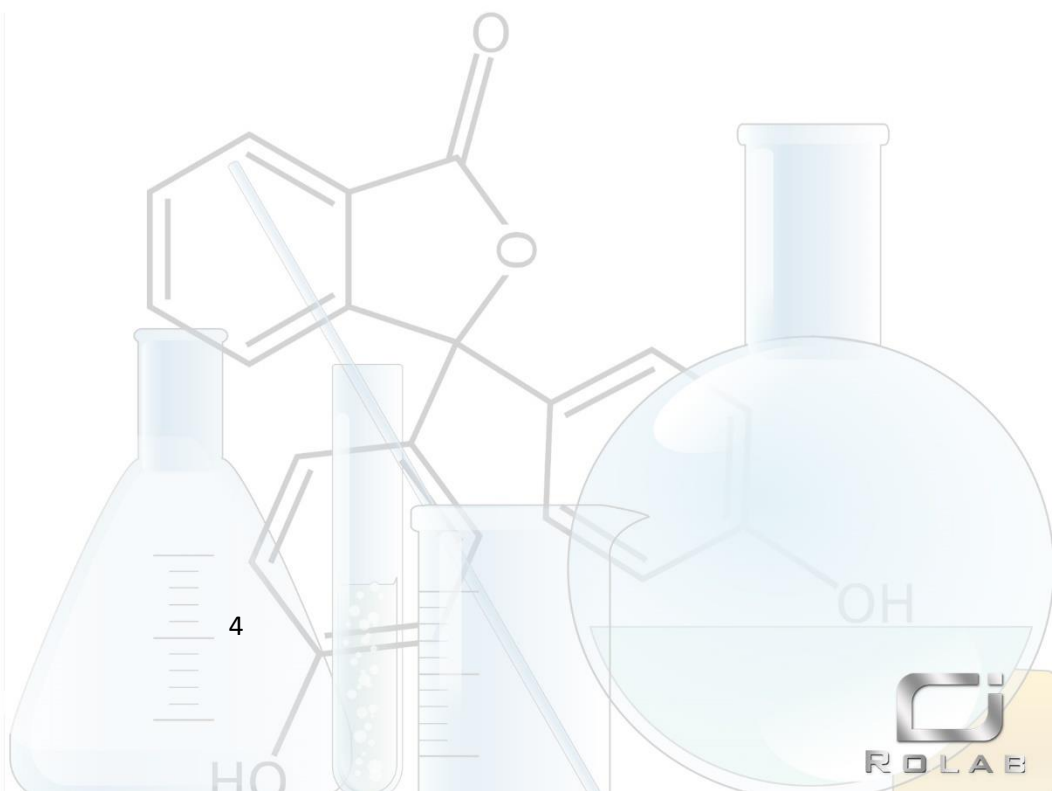


Cod schema	Denumire schema	Analizi	Pret (RON fără TVA)/ Participare)
Programul de imunologie – Valoare de consens ca valoare atribuita			
SIC-EQA-IMN-01 Hormoni, markeri tumoral si markeri virali Proteine speciale	Hormoni - determinare cantitativa SIC-EQA-IMN-01.1	TSH, T3, FT3, T4, FT4, LH, FSH, Prolactina, Progesteron, Testosteron, beta HCG, Estradiol, Cortisol, PTH, ATPO	176
	Markeri tumoral: - CEA, AFP, PSA Total, PSA Free, CA 19-9, CA 125, CA 15-3 - determinare cantitativa - PSA Total, PSA Free - determinare calitativa (imunocromatografie) SIC-EQA-IMN-01.2	CEA, AFP, PSA Total, PSA Free, CA 19-9, CA 125, CA 15-3	269
	Imunoproteine - CRP, ASLO, FR- determinare calitativa (aglutinare) si cantitativa; - C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, Feritina, Transferina - determinare cantitativa - IgE - determinare calitativa (imunocromatografie) SIC-EQA-IMN-01.3	CRP, ASLO, FR, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, Feritina, Transferina	306
	Serologie sifilis - determinare calitativa (aglutinare) SIC-EQA-IMN-01.4	RPR, TPHA, VDRL	
	Determinare AgHBs, Anti HCV, Ag Hbe, Anti Hbe, anticorpi totali si Ig M anti-HAV - determinare calitativa (imunocromatografie) SIC-EQA-IMN-01.6	Ag Hbs, Ag Hbe, Atc anti HAV total, Atc anti HAV IgM, Anti HCV, Anti Hbs, Anti Hbe	385
	Determinare anticorpi anti-HIV - determinare calitativa (imunocromatografie) SIC-EQA-IMN-01.7	Anti HIV 1 si 2	

Cod schema	Denumire schema	Analizi	Pret (RON fără TVA)/ Participare)
Programul de Bacteriologie – Valoare de consens ca valoare atribuita			
SIC-EQA-MIB1 Bacteriologie	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (A)	Tulpina bacteriana: Urocultura	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (B)	Tulpina bacteriana: Coprocultura	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (C)	Tulpina bacteriana: Lichid de punctie	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (D)	Tulpina bacteriana Exudat faringian	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (E)	Tulpina bacteriana Secretie nazala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (F)	Tulpina bacteriana Secretie otica	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (G)	Tulpina bacteriana Secretie conjunctivala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (H)	Tulpina bacteriana Secretie vaginala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (I)	Tulpina bacteriana Secretie uretrala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (J)	Tulpina bacteriana Secretie purulenta	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma</i> SIC-EQA-MIB1 (K)	Tulpina bacteriana Secretie sputa	109

Cod schema	Denumire schema	Analiti	Pret (RON fără TVA)/ Participare)
Programul de Micologie – Valoare de consens ca valoare atribuita			
SIC-EQA-MIB2 Micologie	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (A)</i>	Tulpina fungi Urina	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (B)</i>	Tulpina fungi Coprocultura	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (C)</i>	Tulpina fungi Lichid de punctie	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (D)</i>	Tulpina fungi Exudat faringian	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (E)</i>	Tulpina fungi Secretie nazala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (F)</i>	Tulpina fungi Secretie otica	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (G)</i>	Tulpina fungi Secretie conjunctivala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (H)</i>	Tulpina fungi Ssecretie vaginala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (I)</i>	Tulpina fungi Secretie uretrala	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (J)</i>	Tulpina fungi Secretie purulenta	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (K)</i>	Tulpina fungi Ssecretie sputa	109
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama SIC-EQA-MIB2 (L)</i>	Fungi + Antifungigrama	109

Cod schema	Denumire schema	Analiti	Pret (RON fără TVA)/ Participare)
Programul de Parazitologie – Valoare de consens ca valoare atribuita			
SIC-EQA-MIB Parazitologie	<i>Parazitologie - screening si identificare elemente parazitare materii fecale</i> SIC-EQA-MIB (A)- Iconografic	Materii fecale	139

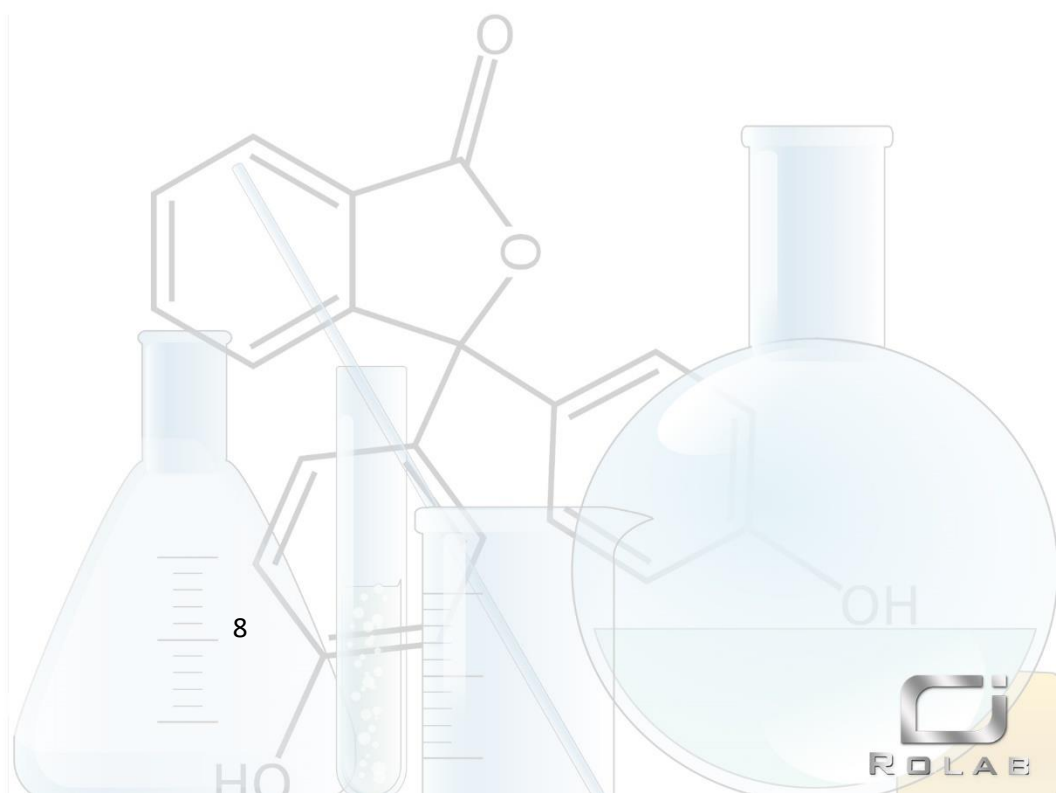

**ROLAB desfășoară control extern de calitate și prin scheme cu
valoare de referință**

Programul de Chimie clinica – Valoare de REFERINTA ca valoare atribuita

SIC-EQA-CCL-01 Chimie clinica	Chimie clinica prin spectrofotometrie SIC-EQA-CCL-01.2	Glucoza, Uree, Proteina totala, Calciu total, Fier, Acid uric, Creatinina, Colesterol, Trigliceride, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Magneziu, TGO, TGP, GGT, Fosfaza alcalina, LDH, Amilaza, Fosfor, Creatinkinaza CK.	199
---	---	---	-----

Programul de Bacteriologie – Valoare de REFERINTA ca valoare atribuita

SIC-EQA-MIB1 Bacteriologie	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (A)	Tulpina bacteriana: Urocultura	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (B)	Tulpina bacteriana: Coprocultura	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (C)	Tulpina bacteriana: Lichid de punctie	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (D)	Tulpina bacteriana Exudat faringian	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (E)	Tulpina bacteriana Secretie nazala	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (F)	Tulpina bacteriana Secretie otica	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (G)	Tulpina bacteriana Secretie conjunctivala	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (H)	Tulpina bacteriana Secretie vaginala	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (I)	Tulpina bacteriana Secretie uretrala	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (J)	Tulpina bacteriana Secretie purulenta	119
	Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma SIC-EQA-MIB1 (K)	Tulpina bacteriana Secretie sputa	119

Programul de Micologie – Valoare de REFERINTA ca valoare atribuita

SIC-EQA-MIB2 Micologie	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (A)	Tulpina fungi Urina	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (B)	Tulpina fungi Coprocultura	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (C)	Tulpina fungi Lichid de punctie	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (D)	Tulpina fungi Exudat faringian	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (E)	Tulpina fungi Secretie nazala	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (F)	Tulpina fungi Secretie otica	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (G)	Tulpina fungi Secretie conjunctivala	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (H)	Tulpina fungi Secretie vaginala	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (I)	Tulpina fungi Secretie uretrala	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (J)	Tulpina fungi Secretie purulenta	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (K)	Tulpina fungi Secretie sputa	119
	<i>Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama</i> SIC-EQA-MIB2 (L)	Fungi + Antifungigrama	119

Schemele de încercări de competență oferite de către ROLAB-IC sunt descrise în Anexa la Certificatul de acreditare Nr. IC 008.

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa certificatul de acreditare ROLAB Nr. IC-008 însoțit de Anexa la adresa <https://www.renar.ro/index.php/oec>.

Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA.

Specificațiile, prețurile și caracteristicile cuprinse în prezenta ofertă **sunt valabile la data** ultimei actualizări a ofertei (**09.12.2025**) și sunt cu titlu informativ – nu constituie obligativitate contractuală. Oferta poate suferi actualizări pe parcursul anului 2026.

ABREVIERI:

- **LAM** – Laborator de analize medicale
- **OIC** – obiect supus încercării de competență - eșantion, produs, material de referință sau alte informații asupra cărora se realizează încercări de competență.
- **SIC** - schemă de încercare de competență

TERMINOLOGIE:

- **O rundă de încercări de competență interlaboratoare** reprezintă secvența completă unică de distribuire a OIC-urilor către LAM, determinarea proprietăților analiților OIC de către LAM, raportarea rezultatelor obținute de LAM către Rolab, și evaluarea acestor rezultate de către Rolab. **Rundele de comparări interlaboratoare sunt planificate să se desfășoare în lunile Martie, Mai, Septembrie și Noiembrie 2026.** Pentru unele scheme, lunile pot diferi iar laboratoarele vor fi informate din timp asupra schimbărilor.
- **schemă de încercare de competență** – SIC - încercare de competență concepută și utilizată în cadrul rundelor, pentru un anumit domeniu de măsurare.
- **Pentru fiecare dintre rundele organizate, pot fi contractate mai multe participări** – laboratoarele pot opta ca să li se trimită *m* OIC-uri pentru SIC selectate (**IMPORTANT! A se vedea Nota 1!**), pentru care vor efectua și raporta *m* determinări, iar Rolab va emite *m*

Nota 1: Pentru fiecare laborator (punct de lucru), pentru fiecare participare, numărul minim de SIC contractate trebuie să fie de cel puțin 10.

rapoarte de evaluare. **De exemplu, să presupunem** că un laborator ar dori să contracteze **a** participări în runda *martie*, **b** participări în runda *mai*, **c** participări în runda *septembrie*, **d** participări în runda *noiembrie* - în total, **$m = a+b+c+d$** participări pentru anul 2026; se vor emite **m** Rapoarte de evaluare aferente acestor participări. Informații despre cum puteți configura mai multe participări se regăsesc în documentul **Instrucțiuni de înscriere**, disponibil pe pagina web Rolab.

- În contextul paragrafului anterior, **se pot contracta până la 3 participări per rundă.**
- **familia de echipamente** reprezintă **echipamentele care produc determinări comparabile** – nu presupune implicit ca echipamentele să aparțină aceluiași producător.

ALTE INFORMAȚII:

1. Pentru anumite scheme, indicăm explicit în Anexa 1 lista echipamentelor acceptate, pentru care ROLAB poate furniza, la data publicării prezentei oferte, un OIC adecvat – vă rugăm să ne contactați dacă echipamentul dvs. nu se regăsește în Anexa 1.
2. Pentru schemele indicate în Anexa 1, pentru fiecare echipament pentru care se dorește participarea, laboratorul va indica obligatoriu producătorul și modelul – astfel încât echipa ROLAB să poată verifica eligibilitatea din punct de vedere tehnic.
3. Pentru schemele care nu apar în Anexa 1, nu există restricții de echipamente.
4. Pentru schemele indicate în Anexa 1, evaluarea determinărilor raportate de către LAM participante se va face prin grupare pe familii de echipamente.
5. Înscrierea la schemele organizate de către ROLAB se va realiza exclusiv prin intermediul platformei online, disponibilă la adresa <https://rolab.ro/inscrieri-ic/>.
6. În cazul în care laboratorul deține mai multe echipamente pentru a efectua analize aferente unei anumite SIC, și dorește să efectueze control extern pentru ele, există două variante:
 - Cantitatea de OIC contractată este suficientă pentru efectuarea determinărilor pe toate echipamentele vizate, iar determinările se fac pentru SIC care **NU SE REGASESC** în Anexa 1 – în acest caz, **configurarea unei participări acoperă până la 3 echipamente**; în faza de raportare,

laboratorul va putea să raporteze, pentru schema și participarea respectivă, **câte un singur set de rezultate obținute, pentru fiecare echipament în parte, pentru maxim 3 echipamente.**

- *Cantitatea de OIC contractată* **NU ESTE** *suficientă* pentru efectuarea determinărilor pe toate echipamentele vizate, **și / sau determinările se fac pentru SIC care SE REGASESC** în Anexa 1.

În acest caz:

- trebuie adăugată o participare suplimentară, pentru SIC respectivă, *cu derogare față de cerința de la Nota 1;*
- echipa ROLAB va verifica compatibilitatea echipamentelor declarate de către laborator:

a) **dacă echipamentele fac parte din aceeași familie de echipamente**, se va contracta ca o singură participare. În faza de raportare, laboratorul va putea să raporteze, pentru schema și participarea respectivă, **câte un singur set de rezultate obținute, pentru fiecare echipament în parte, pentru maxim 3 echipamente.**

b) **dacă echipamentele fac parte din familii diferite de echipamente**, vor trebui contractate participări diferite pentru fiecare familie de echipamente.

Nota 1: Pentru fiecare laborator (punct de lucru), pentru fiecare participare, numărul minim de SIC contractate trebuie să fie de cel puțin 10.

Pentru orice alte informații / detalii / suport ne puteți contacta:

- La telefon: 0747.783.874
- Pe Whatsapp (cont business): 0747.783.874
- Pe e-mail: sic_medicale@rolab.ro, office@rolab.ro

Director ROLAB-IC,
Steluța DUȚĂ

Anexa 1 - Lista echipamentelor acceptate la data publicării versiunii curente a ofertei


A1.1: SIC-EQA-HEM-01.1

Lista echipamentelor acceptate în prezent pentru participare la schema
*Hemoleucogramă automată: Determinarea automată a elementelor figurate ale
sângelui - 5 DIFF SIC-EQA-HEM-01.1*

Producător	Model
ABBOTT	CELL DYN EMERALD 22AL
	CELL DYN RUBY
BECKMAN COULTER	DxH 500
	DxH 520
	DxH 560
	DXH 600
	DXH 690T
	DXH 800
BIOMAXIMA	BM HEM 5TS
BIOTA	VABIO 580
DIAGON	Cellagon 5 Pro
DIATRON	ABACUS 5
Drew Scientific	XL2280
Dymind	DF50
	UN73
ERBA Lachema	ELITE 580
HORIBA	PENTRA 120 RETIC
	PENTRA 60c+
	PENTRA XLR
	PENTRA ES60

Producător	Model
	PENTRA XL80
	YUMIZEN H1500
	YUMIZEN H2500
	YUMIZEN H500 / H500 OT
HUMAN	HUMACOUNT 5D
Hysel Handelsgesellschaft m.b.H.	HYCEL HYCOUNT 5XL
Maccura	F 580
NEOMEDICA	PHOENIX NCC61
NIHON KOHDEN	MEK-8222
	MEK-9100
	MEK-9200
Orphee	MYTHIC 22
	MYTHIC 22 AL
	MYTHIC 60
	MYTHIC 70
SFRI	HEMIX 5-60
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	BC 5800
	BC-5120
	BC-5150
	BC-5300
	BC-5380
	BC-5390
	BC-5390 CRP
	BC-5600
	BC-6000
	BC-6200
	BC-6800Plus
	BC-760

Producător	Model
	BC-780
Siemens Healthcare S.R.L.	ADVIA 560
SPINREACT	SPINCELL 5 COMPACT
Sysmex	XN-350
	XN-450
	XN-550
	XN-1000
	XT-2000i
URIT Medical Electronic co.	URIT 5160
	URIT 5250

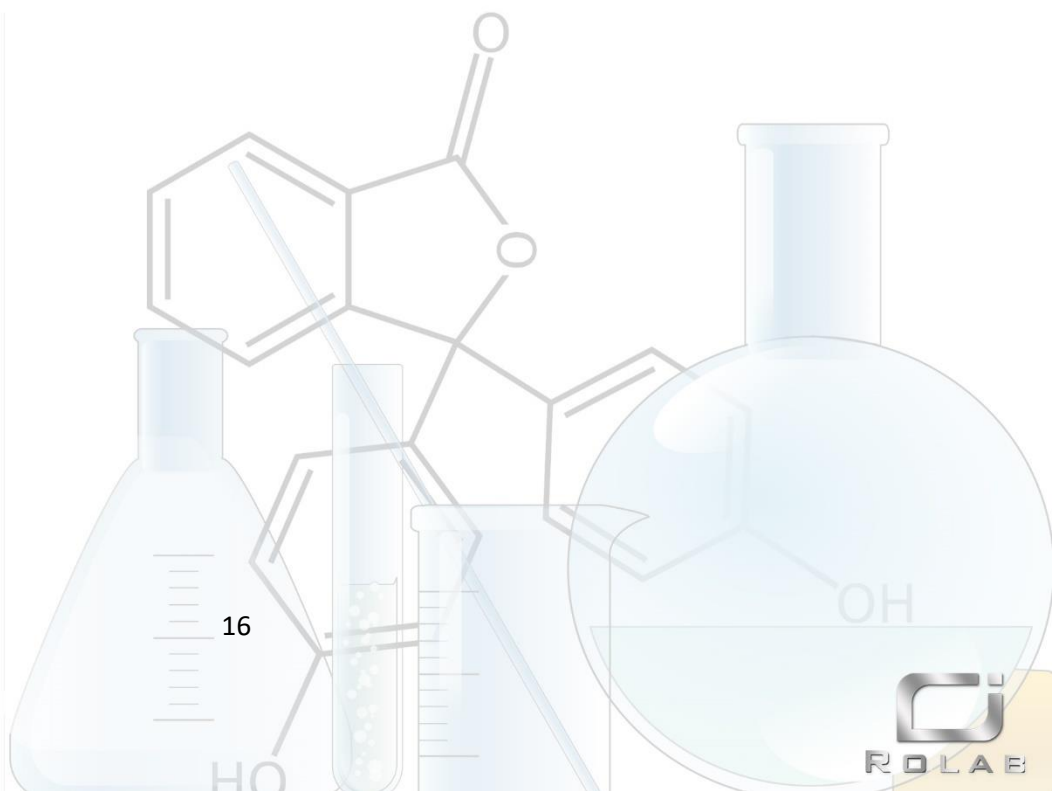

A1.2: SIC-EQA-CCL-01.1 (Consens)

Lista echipamentelor acceptate în prezent pentru participare la schema

*Chimie clinica prin spectrofotometrie SIC-EQA-CCL-01.1 - Programul de Chimie clinică –
Valoare de consens ca valoare atribuită*

Sunt acceptate toate echipamentele de chimie umedă

Nu sunt eligibile echipamentele Ortho Clinical Diagnostics – VITROS


A1.3: SIC-EQA-CCL-01.2 (Referință)

Lista echipamentelor acceptate în prezent pentru participare la schema

*Chimie clinica prin spectrofotometrie SIC-EQA-CCL-01.2 - Programul de Chimie clinică –
Valoare de REFERINȚĂ ca valoare atribuită*

Sunt acceptate toate echipamentele de chimie umedă. Trebuie specificat la înscriere dacă echipamentul face parte din familia ROCHE Cobas

Nu sunt eligibile echipamentele Ortho Clinical Diagnostics - VITROS

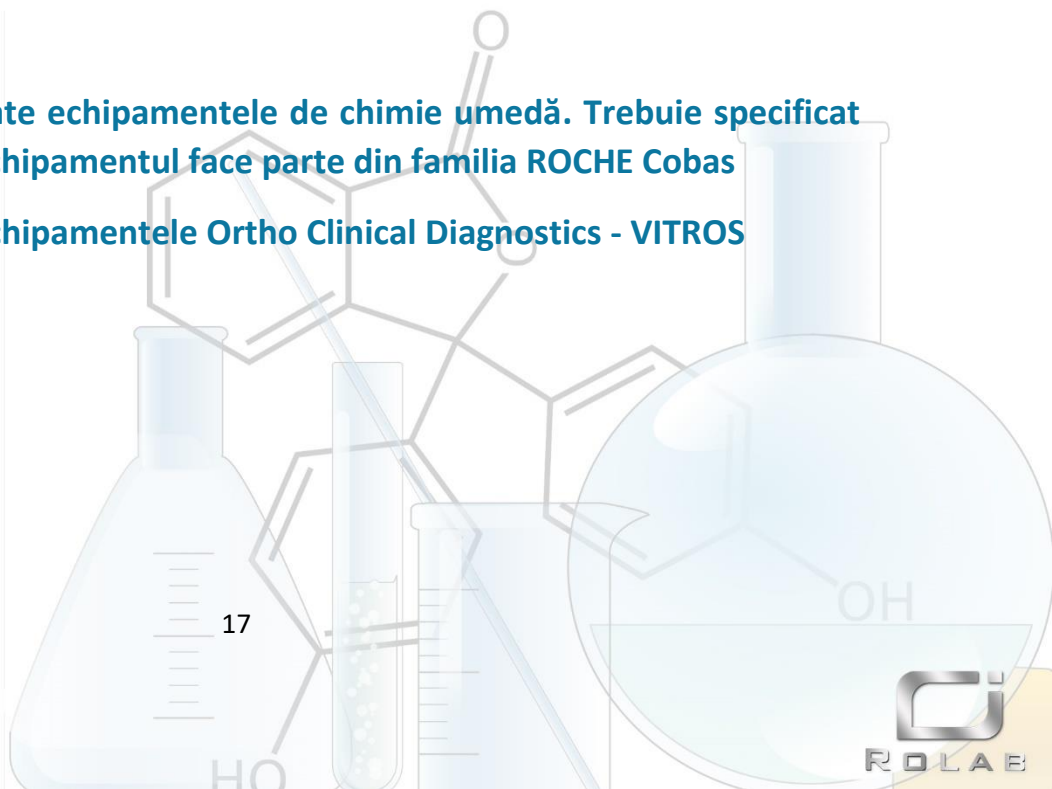

A1.4: SIC-EQA-CCL-02.2

Lista echipamentelor acceptate în prezent pentru participare la schema

Examen complet de urina (bandelete urinare si microscopie optica): Chimie clinica: Examen biochimic al urinii (determinare calitativa): SIC-EQA-CCL-02.2

Producător	Model
77 ELEKTRONIKA	DocUReader 2 Pro
	LabUMat
	LabUMat 2
	LabUReader
	LabUReader Plus 2
	URISED 3 PRO
	URISED MINI
ABBOTT	UroMeter 720
ACON Laboratories	Mission U120
	Mission U500
Analyticon Biotechnologies	Urilyzer 100 Pro
	Urilyzer 500 Pro
	CombiScan500
ARKRAY	AUTION ELEVEN AE-4020
	Aution Max AX-4030
	Aution Max AX-4060
	Pochetchem UA PU-4010
Ave Science Technology	AVE-733
BECKMAN COULTER	iQ200
	iQ200 Elite
	iQ200 Sprint

Producător	Model
Bilimsel Tibbi Urunler	BT URI 50
BIOMAXIMA	BM URI 200
	BM URI 500
DFI Co.Ltd Korea	Cybow Reader 300
	Cybow Reader 720
DIALAB	Strip Analyser 500
DIRUI INDUSTRIAL CO. LTD- China	FUS-1000
	FUS-3000
	FUS-3000Plus
	H-100
	H-500
	H-800
	MUS-3600
Dutch Diagnostics	Uri-Screen 500
ERBA Lachema	LAURA
	LAURA Smart
HUMAN	Combilyzer 13
HUMASIS	U-AQ Smart Urine Analyzer
MACHEREY-NAGEL	URYXXON 500
	URYXXON Relax
NAL VON MINDEN	Reactif Touch
NEOMEDICA	NUA-50
Roche Diagnostics	cobas 6500
	cobas u 411

Producător	Model
	Urysis 1100
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	EU-5600
	UA-66
Siemens Healthcare S.R.L.	ATELLICA UAS800
	CLINITEK Advantus
	CLINITEK Novus
	CLINITEK Status
SPINREACT	URISPIN 120 (U120)
	Verify U120
SYSMEX	UC-1000
	UC-3500
Tody Laboratories Int. SRL	URINE STRIPS READER-S300
	Uripath Reader 300
URIT	URIT-1600
	URIT-180
	URIT-330
	URIT-500B
	URIT-500C
	US-1680
YD Diagnostics CORP	Uriscan Pro

A1.5: SIC-EQA-CCL-02.4


Lista echipamentelor acceptate în prezent pentru participare la schema

ANALIZOARE BECKMAN COULTER

Familia de echipamente iRICELL / iCHEMVELOCITY

Chimie clinica: Examen biochimic al urinei (determinare calitativa) – Strip + probă dedicată leucocite și sediment urină (OIC analizat microscopic) + Sediment urină Iconografic (schemele SIC-EQA-CCL-02.2 + SIC-EQA-CCL-02.3 dedicate pentru analizoare din familia amintită) SIC-EQA-CCL-02.4

Producător	Model
Beckman Coulter	iChem Velocity
	iRICELL 1500
	iRICELL 1500 PRO
	iRICELL 2000
	iRICELL 2000 PRO
	iRICELL 3000
	iRICELL 3000 PRO

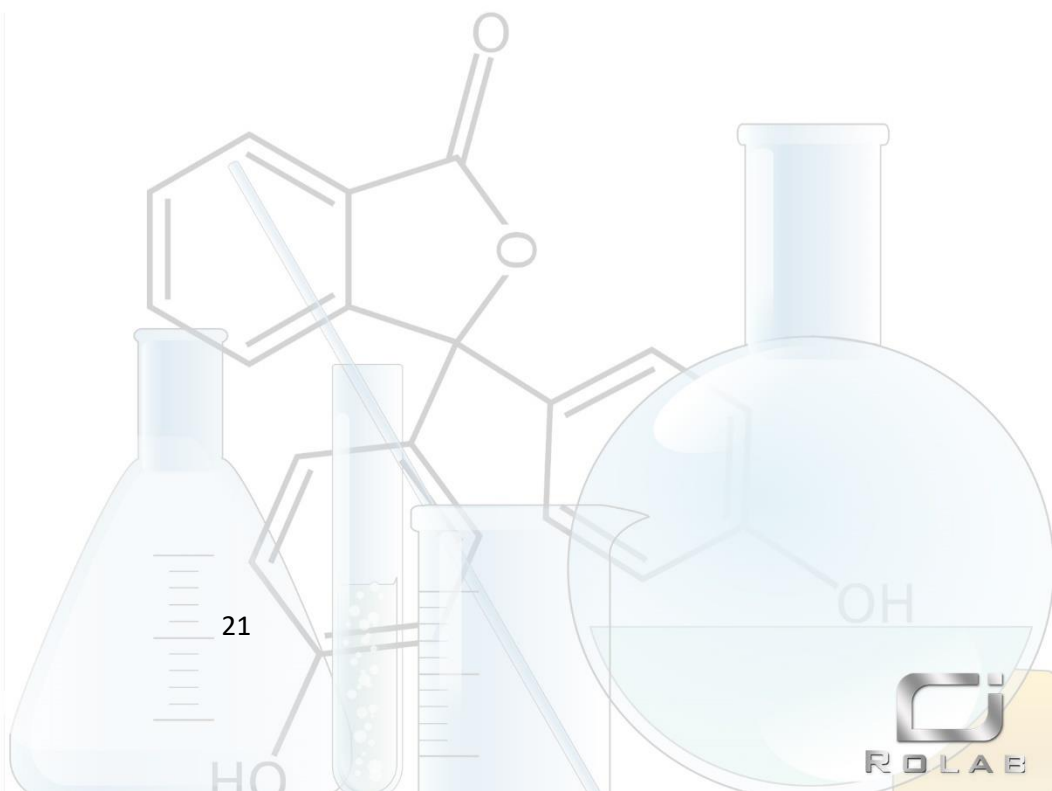

A1.6: SIC-EQA-IMN-01.1

Lista echipamentelor acceptate în prezent pentru participare la schema
*Hormoni, markeri tumorali si markeri virali, Proteine speciale: Hormoni - determinare
cantitativa - ANALIT ATPO: SIC-EQA-IMN-01.1*

Producător	Model
ABBOTT	Alinity ci
	Alinity i
	ARCHITECT i1000SR
	ARCHITECT i2000SR
	ARCHITECT i4000SR
	ARCHITECT ci4100
Awareness Technology (Stat Fax)	Stat Fax 2100
	Stat Fax 4700
	Stat Fax 303 PLUS
Beckman Coulter	Access Immunoassay System 2
	Dxl 600
	Dxl 800
BIOMERIEUX	mini VIDAS
	VIDAS® 3
	VIDAS® KUBE
	VIDAS® PC
Boditech Med Inc.	iCHROMA
	iCHROMA II
	iCHROMA III
	iCHROMA M2
	iCHROMA M3
	iCHROMA-50
DAS	AP22 Speedy
DiaSorin	Liaison XL
Getein Biotech Inc.	MAGICL 6000i

Producător	Model
Rayto (Biosystems)	Rt-2100C
Roche Diagnostics	Cobas e 411 Cobas e 601 Cobas e 801
SHENZEN MICROPROFIT BIOTECH CHINA	MF-T1000
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	CL-1000i CL-1200i CL-2000i CL-2600i CL-900i CL-960i MR-96A
Siemens Healthcare S.R.L.	ADVIA Centaur CP ADVIA Centaur XPT Atellica Solution IM 1600 IMMULITE 1000 IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi
Snibe Co., Ltd.	MAGLUMI 600 MAGLUMI 800 MAGLUMI 4000 MAGLUMI X3 MAGLUMI X6
Tody Laboratories Int. SRL	Test rapid
TOSOH BIOSCIENCE	AIA-360 AIA-900 AIA-2000
Wondfo Biotech	Wondfo Finecare Plus